



# Návod k použití

T3111

T3111L

T3111P

T3111Ex

Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti  
a dalších odvozených vlhkostních veličin  
s výstupy 4 – 20 mA s externí sondou

---

© Copyright: COMET System, s.r.o.

Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu firmy COMET System, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Firma COMET System, s.r.o. provádí neustálý vývoj a vylepšování svých produktů, proto si vyhrazuje právo provést technické změny na zařízení/výrobku bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím přístroje v rozporu s tímto návodem.

Na poškození způsobená užitím přístroje v rozporu s tímto návodem nemusí být poskytnuta bezplatná oprava v záruční době.

Před uvedením přístroje do provozu si podrobně přečtěte celý návod.

---

# Obsah

<b>VŠEOBECNÝ POPIS .....</b>	<b>4</b>
<b>SNÍMAČ T3111EX .....</b>	<b>5</b>
<b>NASTAVENÍ SNÍMAČE OD VÝROBCE.....</b>	<b>6</b>
<b>INSTALACE SNÍMAČE.....</b>	<b>7</b>
<b>INFO REŽIM DISPLEJE.....</b>	<b>8</b>
<b>ZMĚNA NASTAVENÍ SNÍMAČE .....</b>	<b>9</b>
<b>CHYBOVÉ STAVY SNÍMAČE.....</b>	<b>10</b>
<b>TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS PŘÍSTROJE .....</b>	<b>11</b>
<b>TECHNICKÁ DATA .....</b>	<b>12</b>
MĚŘENÉ VELIČINY .....	12
ODVOZENÉ VLHKOSTNÍ VELIČINY .....	13
OBECNÉ PARAMETRY.....	14
PROVOZNÍ PODMÍNKY .....	16
VYŘAZENÍ Z PROVOZU .....	16
ROZMĚROVÝ NÁČRT.....	17
TYPICKÉ APLIKAČNÍ ZAPOJENÍ .....	19
<b>PŘÍLOHA A.....</b>	<b>21</b>

---

## Všeobecný popis

Snímače řady T3111 jsou určeny k měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu bez příměsí agresivních látek. Z naměřených hodnot jsou stanoveny další odvozené vlhkosní veličiny, jako teplota rosného bodu, absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr a specifická entalpie. Měřicí senzory teploty a vlhkosti jsou umístěny v externí sondě, která je s hlavicí elektroniky spojena kabelem.

Naměřené hodnoty včetně hodnot odvozených vlhkosních veličin jsou zobrazovány na dvouřádkovém LCD displeji. Na prvním řádku je zobrazena teplota (°C nebo °F). Veličinu zobrazovanou na druhém řádku lze volit mezi relativní vlhkostí a odvozenou veličinou, nebo je možné cyklické zobrazení obou veličin s intervalem 4 s. Displej může být v případě potřeby zcela vypnut.

Do obvodu se snímač zapojuje pomocí jedné nebo dvou navzájem galvanicky oddělených proudových smyček. Každá se připojuje dvou vodičově a každá vyžaduje napájení z vyhodnocovacího zařízení. Pro správnou funkci snímače musí být vždy zapojena proudová smyčka I1, ze které je napájena měřicí část snímače. Měřené a odvozené veličiny lze programově přiřadit k proudové smyčce výstupu I1 nebo výstupu I2.

Veškerá nastavení snímače se provádějí pomocí osobního počítače připojeného komunikačním kabelem *SP003* (není součástí dodávky). Prostřednictvím konfiguračního programu *Tsensor*, který je zdarma k dispozici na [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz), lze každému z obou proudových výstupů přiřadit jednu z měřených veličin (teplota, relativní vlhkost, odvozená vlhkosní veličina) a nastavit rozsah. Je také možné přiřadit oběma výstupům stejnou veličinu (se stejným rozsahem), pokud je např. nutné připojit dvě vyhodnocovací zařízení. Program umožňuje také provádět justování snímače, postup je popsán v samostatném souboru „*Manuál pro kalibraci.pdf*“, který je součástí instalace programu.

### Variety přístrojů:

- T3111** základní provedení přístroje s kabelovou průchodkou pro připojení výstupního kabelu
- T3111L** přístroj s vodotěsnou vidlicí místo kabelové průchodky pro snadné připojení/odpojení výstupního kabelu (krytí IP67)
- T3111P** provedení přístroje pro měření v prostředí s tlakem do 25 barů
- T3111Ex** jiskrově bezpečné provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu
- T3111Z** toto označení je vyhrazeno pro všechny nestandardní varianty přístrojů. Popis odlišností v jejich provedení není součástí tohoto návodu.

---

# Snímač T3111Ex

Snímač T3111Ex je určen pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu. V souladu s evropskou směrnicí 2014/34/EU (ATEX) splňuje požadavky norem ČSN EN 60079-0:2018 a ČSN EN 60079-11:2012 a jeho provedení je certifikováno - viz certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 13 ATEX 0189X.

Snímač T3111Ex v jiskrově bezpečném provedení je určen pro použití v potenciálně výbušných atmosférách - skupina zařízení IIC. Je vhodný pro aplikace, které vyžadují zařízení kategorie 3G.

Certifikát je k dispozici na [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz).

---

## Nastavení snímače od výrobce

Pokud nebylo při objednávce požadováno speciální nastavení, je snímač z výroby nastaven na následující parametry:

veličina na výstupu I1:	relativní vlhkost, rozsah 4-20 mA odpovídá 0-100 %RV
veličina na výstupu I2:	teplota rozsah 4-20 mA odpovídá -30 až +105 °C
displej:	zapnut
jednotky teploty:	°C
veličina zobrazená na 2. řádku	relativní vlhkost

---

# Instalace snímače

Hlavice s elektronikou je určena pro montáž na zeď. Ze spodní strany je opatřena dvojicí děr k přišroubování. Sondu snímače umístíme do měřeného prostoru. Pro měření teploty a vlhkosti tlakového vzduchu (T3111P) je vhodné použít průtočnou komůrku SH-PP (viz Příloha A). Montážní poloha hlavice s elektronikou a sondy je libovolná, pouze v prostředí ve stavu kondenzace umístíme sondu krytkou směrem dolů.

Připojovací svorkovnice přístrojů T3111, T3111P a T3111Ex je přístupná po odšroubování čtyř šroubů v rozích krabice a sejmutí krytu. Přívodní kabel provlečeme uvolněnou průchodkou a zapojíme (viz „*Typické aplikační zapojení*“). Kabelovou průchodku dotáhneme a přišroubojeme kryt snímače (zkontrolujeme neporušenost těsnění). Zapojení konektoru kabelového přívodu snímače T3111L je uvedeno v kapitole „*Typické aplikační zapojení*“

Pro připojovací vedení proudových smyček se doporučuje použít stíněný kabel o maximální délce 1200 m. Snímače T3111, T3111P a T3111Ex připojujeme kabelem o průměru vnější izolace v rozmezí 3,5 až 8 mm, snímač T3111L kabelem o průměru v rozmezí 3 až 6,5 mm (stínění na straně konektoru nepřipojovat). Při volbě typu kabelu (a způsobu jeho uložení) pro snímač T3111Ex dodržujte podmínky pro bezpečnou instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Kabely musí být vedeny v bezpečné vzdálenosti od kabelů s rušivým elektromagnetickým polem.

Snímač se nedoporučuje dlouhodobě provozovat v prostředí ve stavu kondenzace nebo v prostředí s vodním aerosolem. V takovém případě může voda vzniklá pod krytkou senzorů způsobit výrazné prodloužení doby odezvy na změnu vlhkosti a může dojít i k poškození senzorů.

Snímače nevyžadují žádnou zvláštní údržbu a obsluhu. Je vhodné udržovat v čistotě krytku senzorů a pravidelně ověřovat přesnost měření kalibrací.

---

## Upozornění


---

- Instalaci přístroje, jeho uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze pracovník s kvalifikací dle platných předpisů a norem..
  - Snímač se nesmí připojovat pod napětím.
  - Teplota okolí hlavice snímače T3111Ex nesmí překročit hodnotu 60 °C.
  - Za jistých extrémních okolností se na plastové skřínce snímače T3111Ex může vytvořit elektrostatický náboj schopný inicializace. Přístroj proto nesmí být instalován v místech, kde by vnější podmínky mohly vést k vytvoření elektrostatického nabíjení. Snímač smí být otírán pouze vlhkou utěrkou.
  - Demontáž sondy snímače T3111P se nesmí provádět pod tlakem.
-

---

## Info režim displeje


Některá nastavení nainstalovaného snímače lze ověřit i bez použití počítače. Podmínkou je připojené napájení na proudovou smyčku I1. K prohlížení nastavených hodnot slouží tlačítko umístěné pod víčkem přístroje (mezi displejem a svorkovnicí). K jeho stisknutí použijeme např. šroubovák.



Na LCD displeji se zobrazí typ veličiny přiřazené 1. kanálu (zde „%RH“ = relativní vlhkost, „1“ = 1. kanál). Na dolním řádku se objeví hodnota měřené veličiny pro výstupní proud 4 mA (zde 0 %RH).



Po dalším stisku tlačítka se na LCD displeji zobrazí typ veličiny přiřazené 1. kanálu (zde „%RH“ = relativní vlhkost, „1“ = 1. kanál). Na dolním řádku se objeví hodnota měřené veličiny pro výstupní proud 20 mA (zde 100 %RH).



Dále se na LCD displeji zobrazí typ veličiny přiřazené 2. kanálu (zde „°C“ = teplota, „2“ = 2. kanál). Na dolním řádku se objeví hodnota měřené veličiny pro výstupní proud 4 mA (zde -30 °C).



Na závěr se na LCD displeji zobrazí typ veličiny přiřazené 2. kanálu (zde „°C“ = teplota, „2“ = 2. kanál). Na dolním řádku se objeví hodnota měřené veličiny pro výstupní proud 20 mA (zde 80 °C).

Dalším stiskem tlačítka info režim končí a displej se vrátí zpět na zobrazení měřených veličin.

---

### Upozornění

---

- Po dobu info režimu snímač neměří ani negeneruje analogový výstup. Pokud zůstane snímač v info režimu déle než 15 s, automaticky se vrátí do měřicího cyklu.
  - Ověření nastavení snímače T3111Ex je dovoleno provádět pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
-




---

## Změna nastavení snímače

Nastavení snímače se provádí pomocí zakoupeného komunikačního kabelu SP003, který se připojuje do USB portu osobního počítače. V počítači je nutno mít nainstalován konfigurační program Tsensor, který je zdarma k dispozici na internetové adrese [www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz) (při instalaci prosím věnujte pozornost instalaci ovladačů USB adaptéru)

- odšroubujeme 4 šroubky krytu snímače a kryt sejmeme. Pokud se jedná o snímač už instalovaný do měřicího systému, odpojíme připojovací vodiče od svorek.
- ke snímači připojíme komunikační kabel SP003 (nainstalovaný ovladač detekuje kabel SP003 a vytvoří v počítači virtuální COM port)
- spustíme konfigurační program Tsensor a dále pokračujeme podle jeho pokynů
- po ukončení nastavení odpojíme kabel od snímače a podle potřeby snímač opět připojíme do měřicího systému a našroubujeme kryt

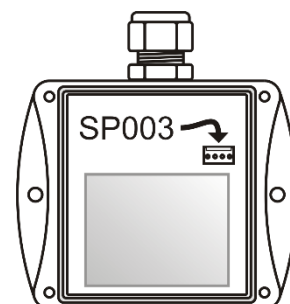

---

### Upozornění

---

- Změnu nastavení snímače T3111Ex pomocí kabelu SP003 je dovoleno provádět pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
-

---

## Chybové stavy snímače

Při provozu snímač neustále provádí kontrolu svého stavu, v případě zjištění chyby zobrazí na LCD displeji odpovídající chybový kód:

- Error 0** - na prvním řádku displeje zobrazeno „Err0“ (hodnota výstupního proudu je  $< 3,8$  mA). Chyba kontrolního součtu CRC uloženého nastavení v paměti snímače. K této chybě dochází při nedodržení postupu zápisu do paměti snímače, zápisem na jiné adresy než je dovoleno, případně nastalo poškození kalibračních dat. V tomto stavu snímač neměří a ani se nepočítají hodnoty odvozených vlhkostních veličin. Jedná se o závažnou chybu, pro její odstranění kontaktujte distributora přístroje.
- Error 1** - měřená nebo odvozená veličina je nad horní hranici povoleného rozsahu. Místo hodnoty měřené veličiny je zobrazeno „Err1“ (hodnota výstupního proudu je  $> 22,0$  mA). Tento stav nastane v případě že:
- měřená teplota je větší než cca  $600$  °C (tzn. velký neměřitelný odpor teplotního čidla, pravděpodobně je rozpojeno).
  - relativní vlhkost je větší než  $100$  %, tzn. zničené čidlo vlhkosti, nebo nelze vlhkost spočítat z důvodu chyby při měření teploty.
  - nelze spočítat odvozenou veličinu (chyba při měření teploty nebo relativní vlhkosti, případně překročen maximální rozsah).
- Error 2** - měřená nebo odvozená veličina je pod dolní hranici povoleného rozsahu. Místo hodnoty měřené veličiny je zobrazeno „Err2“ (hodnota výstupního proudu je  $< 3,8$  mA). Tento stav nastane v případě že:
- měřená teplota je menší než cca  $-210$  °C (tzn. malý odpor teplotního čidla, pravděpodobně zkrat)
  - relativní vlhkost je menší než  $0$  %, tzn. poškozené čidlo pro měření relativní vlhkosti, nebo nelze vlhkost spočítat z důvodu chyby při měření teploty
  - nelze spočítat odvozenou veličinu (chyba při měření teploty nebo relativní vlhkosti)
- Error 3** - na prvním řádku displeje zobrazeno „Err3“. Jde o chybu vnitřního A/D převodníku (převodník neodpovídá, pravděpodobně došlo k jeho poškození). V tomto stavu snímač neměří a ani se nepočítají odvozené veličiny. Jedná se o závažnou chybu, pro její odstranění kontaktujte distributora přístroje

---

## Technická podpora a servis přístroje

Technickou podporu a servis zajišťuje distributor tohoto přístroje. Kontakt na něj je uveden v záručním listu, dodaném s přístrojem. V případě potřeby můžete také využít diskusní fórum na <http://www.forum.cometsystem.cz/>.

---

# Technická data

---

## Měřené veličiny

### Teplota:


přesnost:	$\pm 0,4$ °C
rozsah:	-30 až +105 °C
rozlišení:	0,1 °C
doba odezvy:	t <sub>90</sub> < 6 min <b>T3111</b> t <sub>90</sub> < 6 min <b>T3111L</b> t <sub>90</sub> < 6 min <b>T3111Ex</b> t <sub>90</sub> < 16 min <b>T3111P</b> (hodnoty platí pro teplotní skok 20 °C)

### Relativní vlhkost:

přesnost:	$\pm 2,5$ %RV v rozsahu 5 až 95 %RV při 23 °C
rozsah:	0 až 100 %RV
rozlišení:	0,1 %RV
doba odezvy:	t <sub>90</sub> < 30 s (skok 65 %RV při konst. teplotě)

Uvedené přesnosti měření platí pro hodnoty zobrazené na LCD displeji přístroje. Platí také pro analogové výstupy za předpokladu, že krajní hodnoty výstupu jsou nastaveny uvnitř rozsahu měření.

### Omezení rozsahu měření teploty a relativní vlhkosti

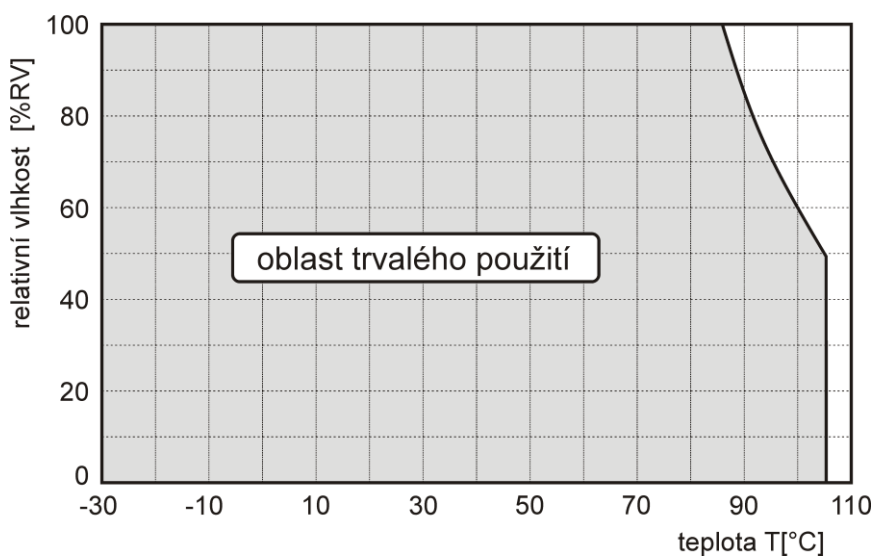

## Odvozené vlhkostní veličiny



### Teplota rosného bodu:

přesnost:

$\pm 1,5\text{ °C}$  při okolní teplotě  $T < 25\text{ °C}$  a  $RV > 30\%$ ,  
podrobně viz grafy

rozsah

-60 až +80 °C

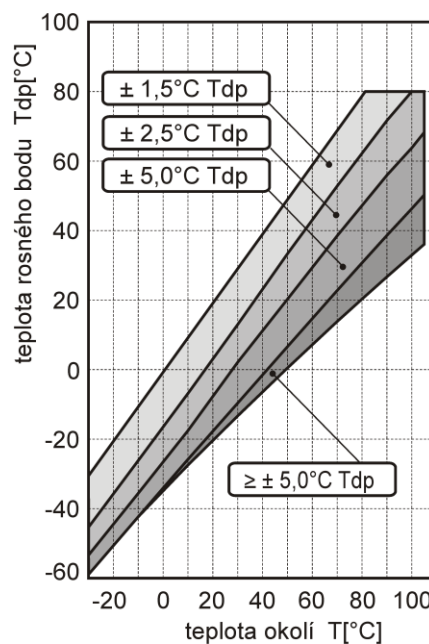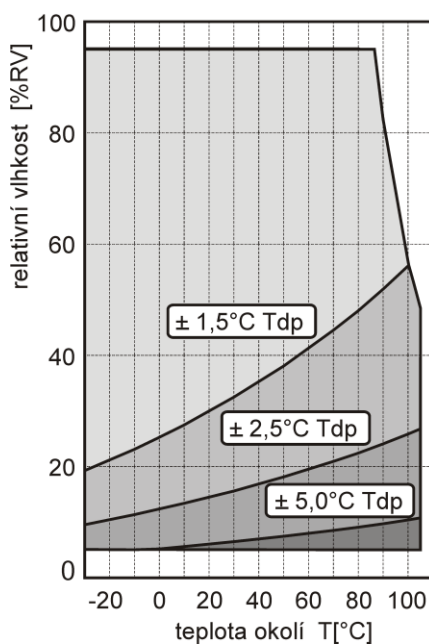


### Absolutní vlhkost:

přesnost:

$\pm 1,5\text{ g/m}^3$  při okolní teplotě  $T < 25\text{ °C}$ ,  
podrobně viz graf

rozsah:

0 až  $400\text{ g/m}^3$

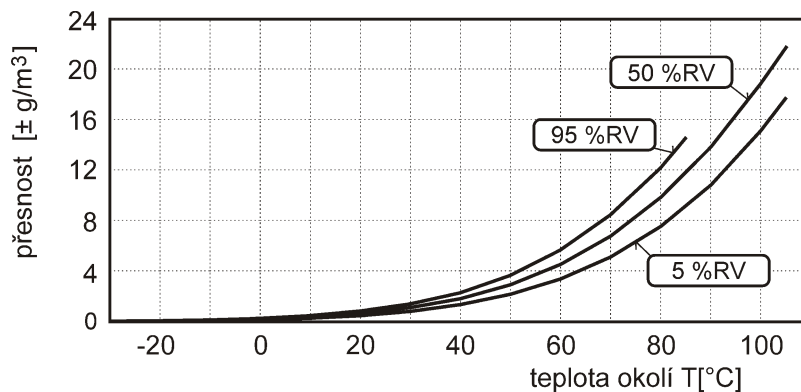

---

### **Měrná vlhkost:**

Hodnota této veličiny je závislá na atmosférickém tlaku. Při výpočtu se používá konstantní hodnota uložena v paměti přístroje. Nastavení od výrobce (1013 hPa) lze změnit pomocí uživatelského programu.

přesnost:  $\pm 2$  g/kg při okolní teplotě  $T < 35$  °C  
rozsah: 0 až 550 g/kg

### **Směšovací poměr:**

Hodnota této veličiny je závislá na atmosférickém tlaku. Při výpočtu se používá konstantní hodnota uložena v paměti přístroje. Nastavení od výrobce (1013 hPa) lze změnit pomocí uživatelského programu.

přesnost:  $\pm 2$  g/kg při okolní teplotě  $T < 35$  °C  
rozsah: 0 až 995 g/kg

### **Specifická entalpie:**

Hodnota této veličiny je závislá na atmosférickém tlaku. Při výpočtu se používá konstantní hodnota uložena v paměti přístroje. Nastavení od výrobce (1013 hPa) lze změnit pomocí uživatelského programu.

přesnost:  $\pm 4$  kJ/kg při okolní teplotě  $T < 35$  °C  
rozsah: 0 až 995 kJ/kg

Hodnoty veličin odvozených z měřené teploty a vlhkosti včetně jejich přesnosti je možné podrobně zjistit pomocí programu **Conversions**, který najdete na internetové adrese <http://www.cometsystem.cz>.

---

## **Obecné parametry**

### **Napájení:**

9 až 30 Vdc

### **Proudový výstup v případě chyby:**

< 3,8 mA nebo > 22 mA

### **Doporučený interval kalibrace:**

1 rok (*relativní vlhkost 1 rok, teplota 2 roky*)

### **Stupeň krytí:**

elektronika IP65, senzory jsou chráněny krytkou s krytím IP40

---

**Mechanické připojení sondy T3111P:**

G1/2 s těsněním O-kroužkem

**Skladovací teplota:**

-30 až +80 °C

**Skladovací vlhkost:**

0 až 100 %RV bez kondenzace

**Certifikace snímače T3111Ex:**

certifikát: FTZÚ 13 ATEX 0189X

označení:  II 3G Ex ic IIC T6 Gc

shoda s normami: ČSN EN 60079-0:2018 a ČSN EN 60079-11:2012

jiskrově bezpečné parametry pro smyčku I1 a I2:

$U_i = 30 \text{ V}$ ,  $I_i = 100 \text{ mA}$ ,  $I_o = 22 \text{ mA}$ ,  $C_i \sim 0$ ,  $L_i \sim 0$

zvláštní podmínka pro bezpečné použití (symbol „X“): za jistých extrémních okolností se na plastové skříňce snímače může nahromadit elektrostatický náboj schopný inicializace. Přístroj nesmí být instalován v místech, kde by vnější podmínky mohly vést k vytvoření elektrostatického nabíjení. Zařízení smí být otíráno pouze vlhkou utěrkou.

**Elektromagnetická kompatibilita:**

ČSN EN 61326-1

**Hmotnost:**

T3111, T3111L, T3111Ex sonda 1m	210 g
T3111, T3111L, T3111Ex sonda 2m	250 g
T3111, T3111L, T3111Ex sonda 4m	330 g
T3111P sonda 1m	260 g
T3111P sonda 2m	300 g
T3111P sonda 4m	380 g

**Materiál skříňky:**

ABS

**Materiál pouzdra sondy T3111P:**

dural s povrchovou úpravou černým eloxem

---

## Provozní podmínky

### Rozsah provozní teploty hlavice s elektronikou :

-30 až +80 °C    **T3111**  
-30 až +80 °C    **T3111L**  
-30 až +80 °C    **T3111P**

### Rozsah teploty okolí hlavice s elektronikou :

-30 až +60 °C    **T3111Ex**

### Rozsah provozní teploty sondy:

-30 až +105 °C

### Rozsah provozní vlhkosti:

0 až 100 %RV (bez kondenzace)

### Rozsah provozního tlaku sondy T3111P:

do 25 barů

### Dovolená rychlost proudění měřeného média pro sondu T3111P:

25 m/s při tlaku 1 bar (1 m/s při tlaku 25 barů)

---


## Vyřazení z provozu

Snímač odpojíme a zajistíme jeho likvidaci podle platné legislativy pro zacházení s elektroodpady.




## Rozměrový náčrt


T3111  
T3111Ex

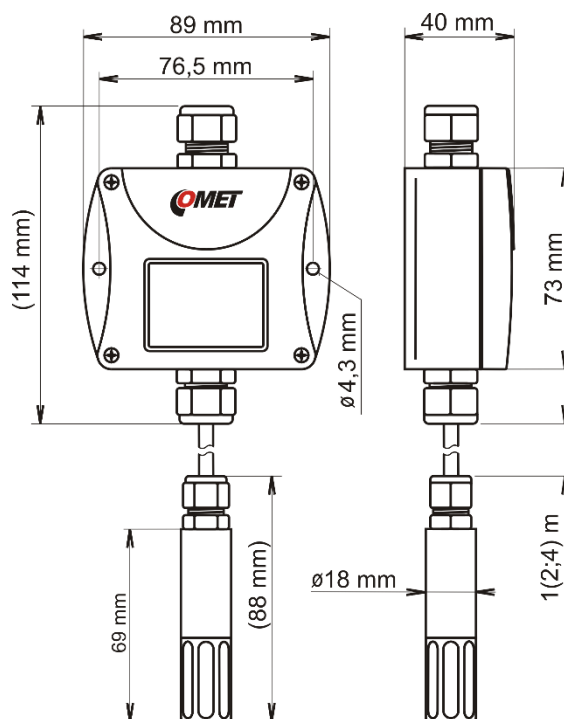

T3111L

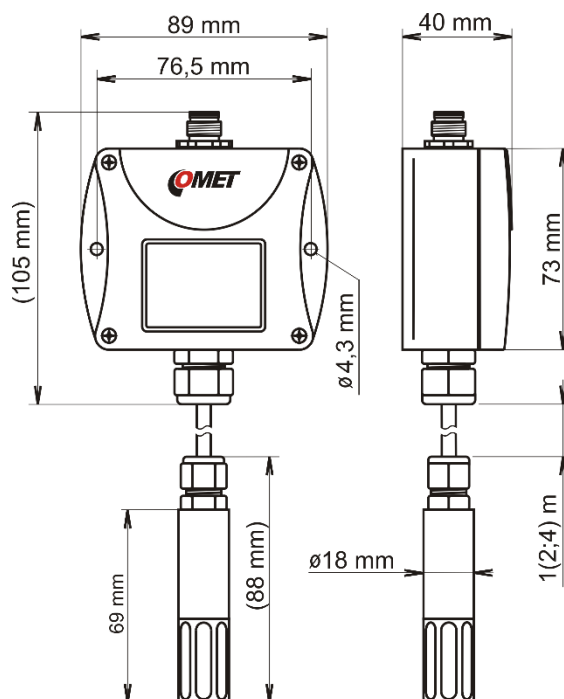


**T3111P**

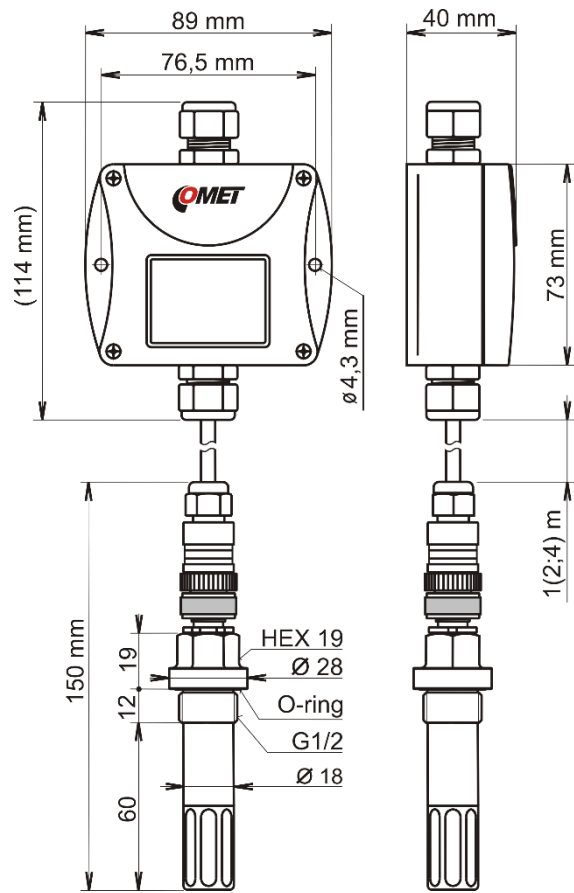


## Typické aplikační zapojení

T3111  
T3111P

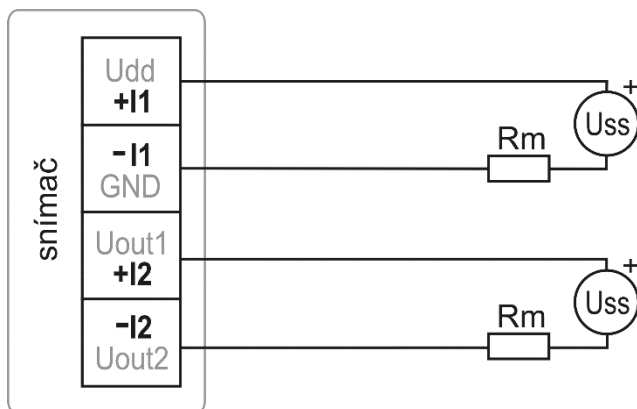

hodnota odporu smyčky  $R_c = R_m + \text{odpor vodičů}$  musí splňovat podmínku  $R_c[\Omega] < 40 \times U_{ss}[V] - 360$

T3111Ex

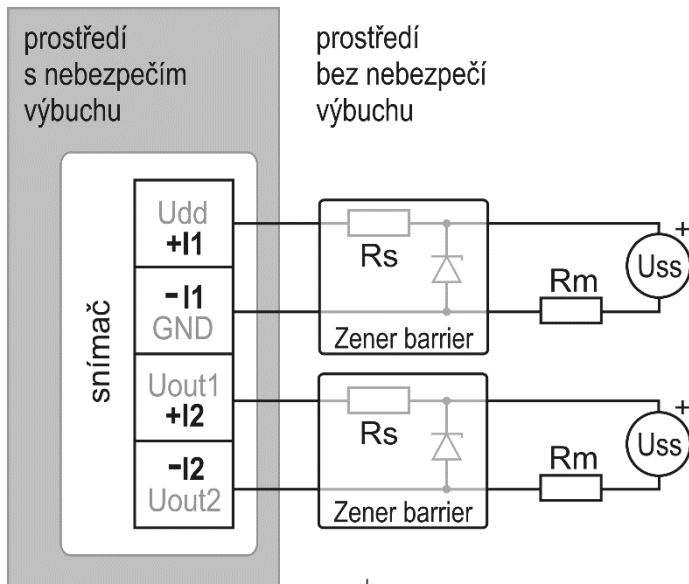


hodnota odporu smyčky  $R_c = R_s + R_m + \text{odpor vodičů}$  musí splňovat podmínku  $R_c[\Omega] < 40 \times U_{ss}[V] - 360$

jiskrově bezpečné parametry snímače:

$$U_i = 30 \text{ V}, I_i = 100 \text{ mA}, I_o = 22 \text{ mA}, C_i \sim 0, L_i \sim 0$$

---


### T3111L

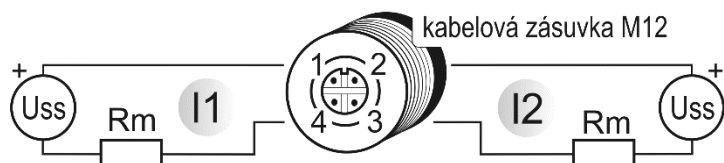

hodnota odporu smyčky  $R_c = R_m + \text{odpor vodičů}$  musí splňovat podmínku  $R_c[\Omega] < 40 \times U_{ss}[V] - 360$

## Příloha A

Sonda pro měření vlhkosti tlakového vzduchu by měla být umístěna přímo do tlakového potrubí, aby bylo dosaženo vyšší přesnosti měření a krátké doby odezvy. Jsou však případy, kdy takové umístění není možné. Důvodem bývá vysoká rychlost vzduchu, vysoká teplota, velké znečištění, malý průměr potrubí apod. Takové situace pak řešíme umístěním sondy do průtočné měřicí komůrky. Na obrázku je základní uspořádání vzorkovacího systému s komůrkou SH-PP.

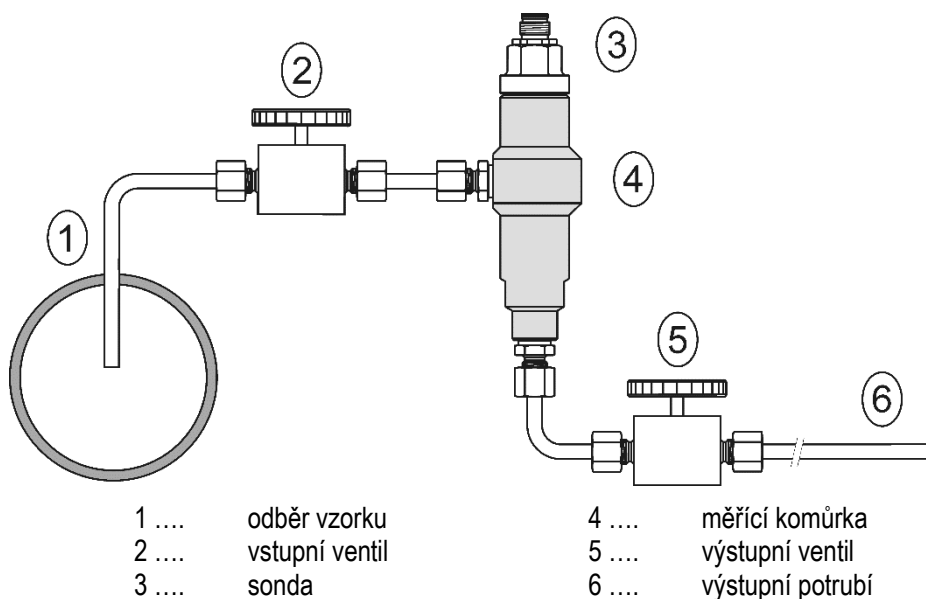

**odběr vzorku (1)** - konec trubky umístit do středu tlakového potrubí (rozložení vlhkosti v průřezu potrubí není homogenní). Pro dosažení krátké doby odezvy zkrátit délku vzorkovacího potrubí na minimum (jednotky metrů).

**vstupní ventil (2)** - v případě výměny sondy či jiné činnosti slouží k přerušení odběru. Tento ventil nepoužívat pro regulaci průtoku!

**výstupní ventil (5)** - slouží k nastavení rychlosti proudění vzduchu. Výsledek měření není zpravidla ovlivněn vzorkovaným množstvím vzduchu, s klesající rychlostí průtoku však roste doba odezvy.

**výstupní potrubí (6)** - v případě, že měřený vzduch je vypouštěn do atmosféry, volit délku výstupního potrubí asi 1,5 m (pro doporučený průměr trubek 6mm). Důvodem je vyloučení vlivu okolní atmosféry na přesnost měření.

Uvedené základní uspořádání systému můžeme doplnit dle konkrétní aplikace o filtry, chladiče (při vysoké teplotě odebíraného vzorku vzduchu), měření průtoku a tlaku, apod. Dbáme na dokonalou těsnost všech spojů, používáme vhodných korozivzdorných materiálů. Sklony potrubí volíme tak, aby nedošlo k hromadění kapaliny v systému.

### Technické parametry komůrky SH-PP

Materiál komůrky:  
Vstupní a výstupní připojení:  
Připojení sondy:  
Rychlost průtoku vzduchu komůrkou:  
Provozní tlak:  
Váha:

nerezová ocel (DIN 1.4301)  
závit G1/8  
závit G1/2  
0,1 až 3 l/min  
do 25 barů  
580 g

**Poznámka:** Šroubení nejsou součástí dodávky.

